



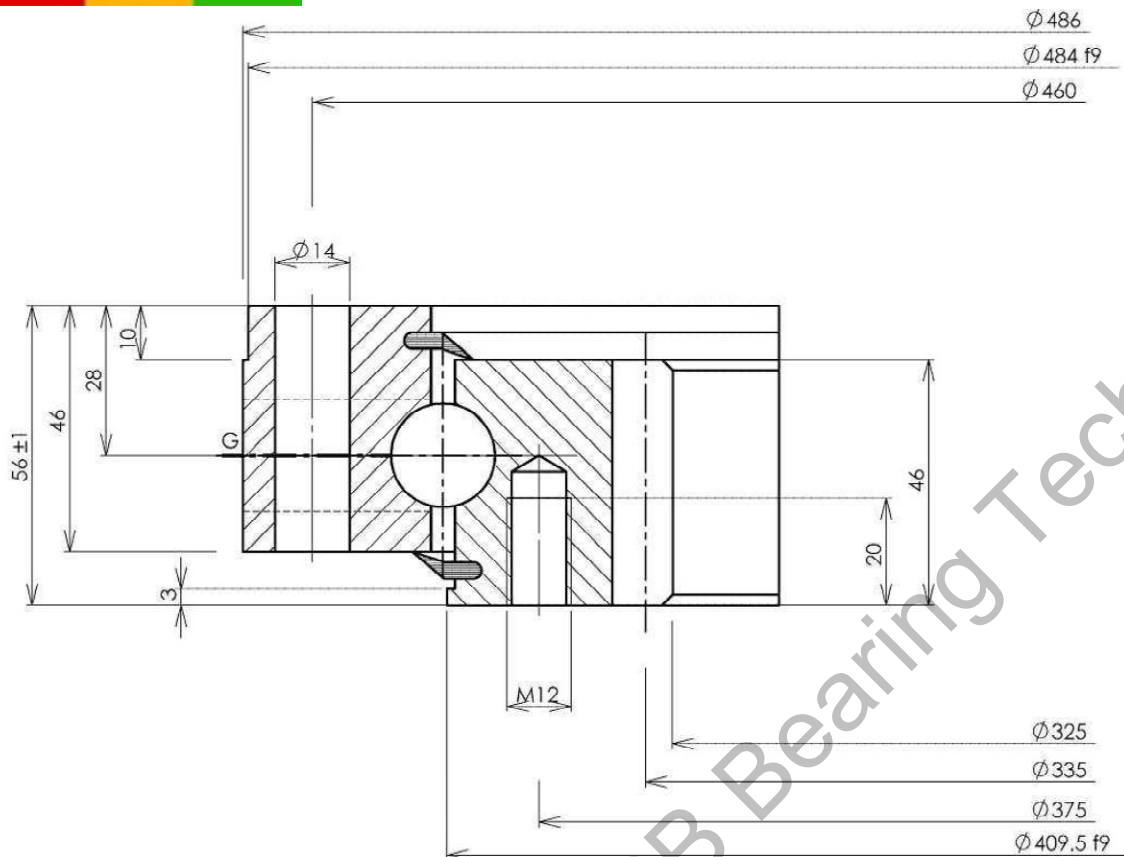

Implantation suivant A
Implantation according to A
Ansicht nach A

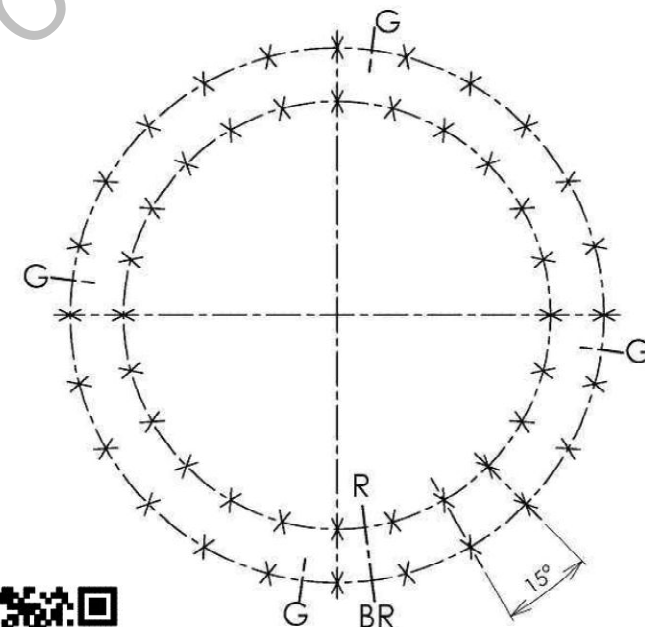

Denture - Gear - Verzahnung Droite		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 et ISO 8015 General tolerances according to IT-ETR-061 and ISO 8015 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061 und ISO 8015				Masse estimée 31 kg Gewicht ca 31 lbs Estimated weight	N° 32-0411-01
Module 5 Module - Modul Diametral pitch	Angle de pression 20° Pressure angle Eingriffswinkel						